

Informace a prodej:

ELKOV elektro a.s.


Kšírova 701/255

Brno 19

tel: 777 736 396

Přístroj je certifikován:

Ústavem klinické mikrobiologie

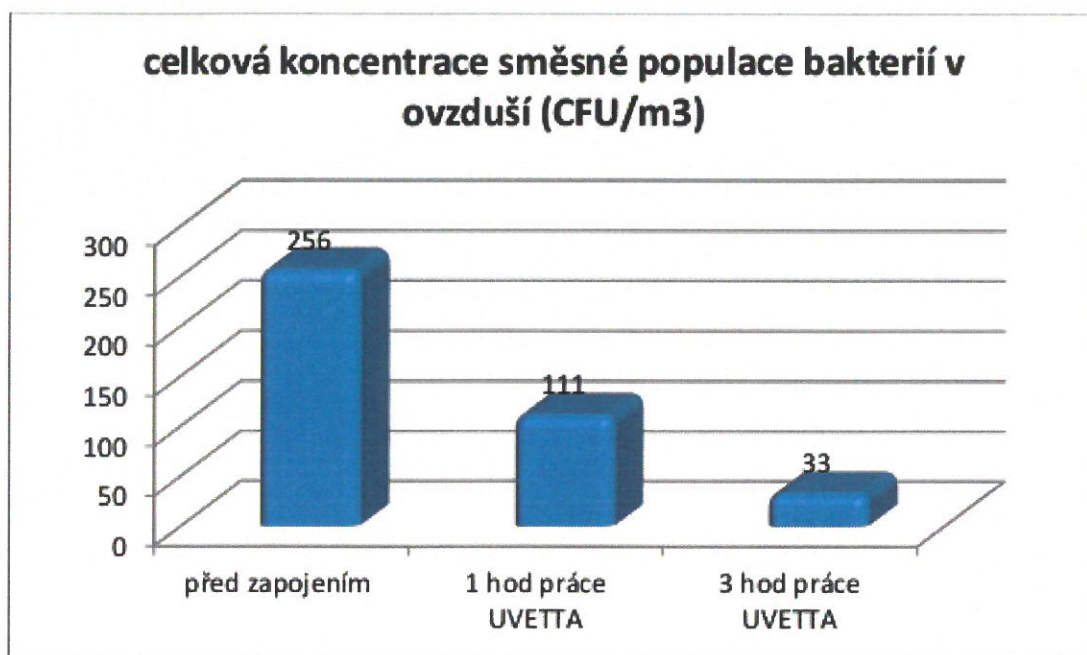

Obr. 1 Grafické znázornění výsledků testování celkové koncentrace směsné populace bakterií, měření před a po zapojení přístroje UVETTA (CFU/m³)

Závěr 1: V testování celkové směsné populace bakterií v ovzduší došlo při práci přístroje UVETTA po 1 hodině k poklesu o 56,6 %. Po 2 hodinách práce přístroje UVETTA byl zaznamenán pokles celkové směsné populace bakterií v ovzduší o 87,1 % ve srovnání s měřením před zapojením přístroje.